

بسمه تعالیٰ

شماره ..... ۵۱۸/۱۰۱۲۳۹  
تاریخ ..... ۷۸/۱۱/۲  
پیوست



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  
مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی امام رضا(ع)  
Imam Reza medical research & training hospital  
Tabriz - Iran

## فرم استعلام خرید کالا و یا خدمات

از : مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع)  
سلام علیکم

احتراماً این مرکز در نظر دارد، **کنسولهای طبی بالای تخت** بیمار را با مشخصات ذیل از طریق استعلام بهاء، خریداری نماید. لذا خواهشمند است پیشنهاد قیمت خود را مطابق با اطلاعات ذکر شده در ذیل، در سربرگ شرکت تکمیل و پس از مهور نمودن به مهر شرکت و امضاء مدیرعامل محترم شرکت تا تاریخ ۹۸/۱۱/۲۴ در پاکت سرسته تحويل دبیرخانه مرکز داده و رسید مربوطه را اخذ نماید. بدینه است پاکت های واصله در موعد مقرر با حضور مسئولین مربوطه گشایش و از برندۀ جهت اقدام آتی دعوت به عمل خواهد آمد.

### الف- جدول مشخصات الزامی اجرای کنسول

- ۱- جنس رویه کنسول از آلومینیوم آنادایز(عایق جریان الکتریکی) باشد.
- ۲- جنس ورق زیر کنسول از آلومینیوم آنادایز(عایق جریان الکتریکی) باشد.
- ۳- جنس واشرهای مصرفی آلتلها سیلیکونی باشد.
- ۴- کلید روشن و خاموش چراغها و پریزها ساخت شرکت البرز، طرح لگراند باشد.
- ۵- کلید روشن و خاموش یک عدد دوپل و یا دو عدد یک پل باشد.
- ۶- پریزهای برق ۱۶ آمپر بوده و به ازای هر تخت ۴ عدد پریز برق نرمال و ۲ عدد پریز UPS در نظر گرفته شود.
- ۷- کنسولهای دارای ۲ عدد چراغ بالای کنسول و ۱ عدد چراغ بایین کنسول باشد، و چراغها از نوع ایرانی LED و ۲۰ وات باشد.
- ۸- امکان نصب احضار پرستار بر روی کنسولها باشد.
- ۹- کنسولها به رنگ کرم با کد رنگ ۱۰۱۳ باشد.
- ۱۰- رنگ کنسولها از نوع پودری الکترواستاتیک مقاوم در برابر مواد ضد عفنونی کننده باشد.
- ۱۱- ابعاد نامی کنسولها ۱۲۰ سانتی متر باشد و قیمت کنسولها برای افزایش طول به ازای هر ۱۰ سانتی متر باید مشخص گردد.
- ۱۲- جای تب سنج و نام بیمار وجود داشته باشد.
- ۱۳- میزان تحمل فشار آلتلها اکسیژن حداقل ۶ بار باشد.
- ۱۴- مدت زمان گارانتی کلیه اجزای کنسول بدون قید و شرط ۲ سال بوده و دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش باشند.

آدرس: تبریز- خیابان دانشگاه مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی امام رضا(ع)

سایت: [www.tbzmed.ac.ir](http://www.tbzmed.ac.ir)

تلفن: ۰۳۴۷۵۰۱-۹۰۳۴۷۰۵۴ دورنویس: ۰۳۵۰۹۹۰ تلفن گویا: ۰۳۴۷۵۰۱-۲

وبلاگ: [www.irepr.blogfa.com](http://www.irepr.blogfa.com)

«بسمه تعالیٰ»

شماره .....  
تاریخ .....  
پیوست .....



**۱۵- در صورت وجود قابلیتی خاص و مهم در کنسول معرفی شده، قابلیت مذکور ذکر و با علامت \* مشخص گردد.**

ب- دارای مجوز تولید معابر از اداره کل تجهیزات پزشکی باشد.

ج- محل تحويل کنسول مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) بوده و هزینه نصب آن بر عهده فروشند بوده و هیچ گونه هزینه‌ای بابت نصب، باربری، بیمه و ... از طریق این مرکز پرداخت نخواهد گردید.

د- کلیه اطلاعات خواسته شده به ترتیب تهیه و تمامی صفحات توسط مدیر عامل شرکت امضاء و ممهور به مهر شرکت گردد.

ه- شرکت برند استعلام موظف و متعدد به ارائه فاکتور مطابق با پیشنهاد قیمت و ارائه تعهد کنی (برگه گارانتی) از زمان نصب به مدت اعلام شده در استعلام می‌باشد.

و- در صورت مشاهده هر گونه مغایرت بین مشخصات ارائه شده و کالای تحویلی، مرکز مختار به عودت کنسولها می‌باشد.


ز- مرکز در قبول و رد پیشنهاد قیمت مختار می‌باشد.

ح- مبلغ کنسولها پس از تحویل، نصب، راه اندازی و آموزش از طرف شرکت قابل مطالبه می‌باشد.

ط- مدت زمان تحویل و نصب کنسولها از زمان عقد قرارداد باید مشخص گردد.

تعداد کنسولها به شرح ذیل می‌باشد.

ردیف	شرح	تعداد
۱	کنسول ۳ گاز (۲ آلت اکسیژن، ۱ آلت و کیوم، ۱ آلت هوای فشرده)	۳۷
۲	کنسول ۳ گاز (۱ آلت اکسیژن، ۱ آلت و کیوم، ۱ آلت هوای فشرده)	۵۴
۳	کنسول یکپارچه طولی به متراز ۶ متربرای ۳ تخت (۲ آلت اکسیژن، ۱ آلت و کیوم، ۱ آلت هوای فشرده)	۱
۴	کنسول یکپارچه طولی به متراز ۶ متربرای ۳ تخت (۱ آلت اکسیژن، ۱ آلت و کیوم، ۱ آلت هوای فشرده)	۲

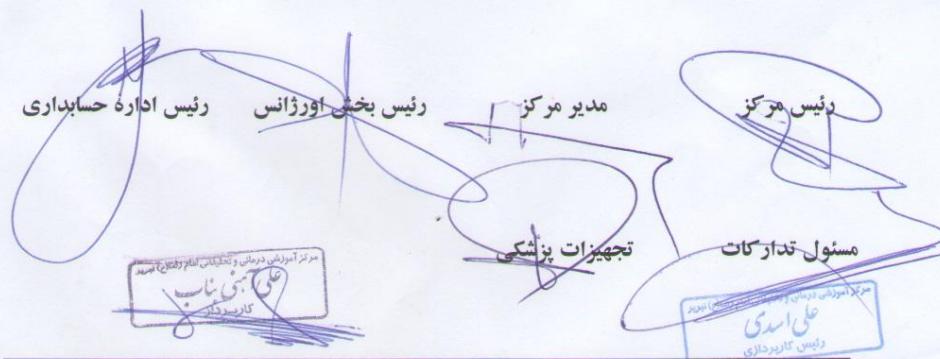

آدرس: تبریز- خیابان دانشگاه مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی امام رضا(ع)

www.tbzmed.ac.ir

تلفن: ۰۳۳۴۷۰۵۰۱-۲ تلفن گویا: ۰۳۳۵۰۹۰-۰۳۴۷۰۵۰۱

وبلایک: www.irepr.blogfa.com